


Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e

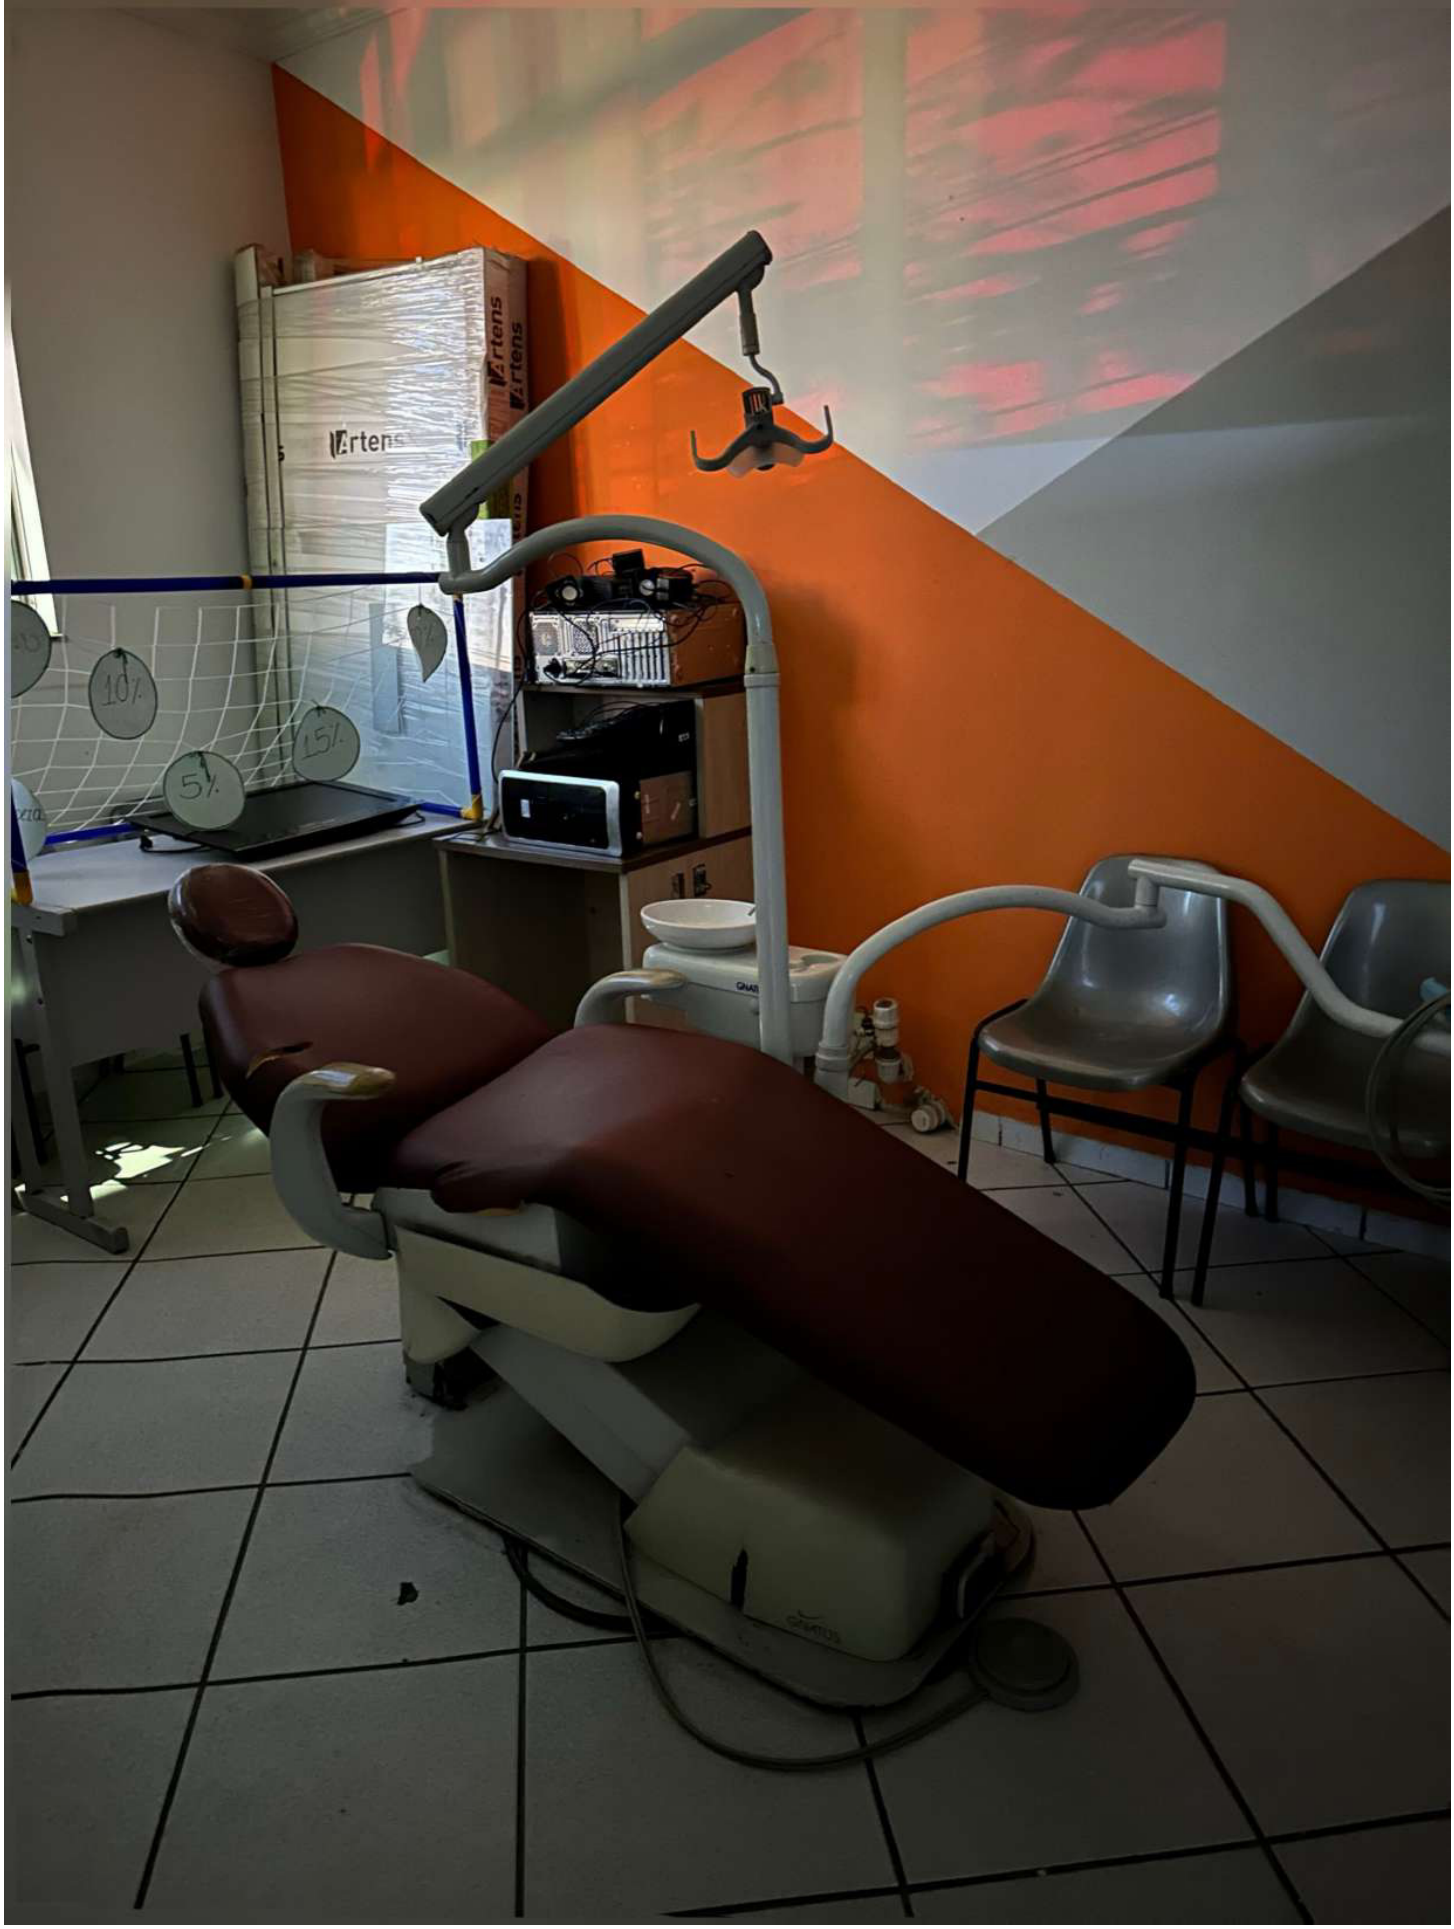

Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e

CE 0434

GNATUS
EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA.
Rod. Abrão Assed, Km 53+450m - Ribeirão Preto - S.P. - Brasil

GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS LTDA

TIPO B CLASSE I
TYPE B CLASS I
TIPO B CLASE I

MODELO / MODEL	APARELHO / EQUIPMENT / APARATO
TIMEX-70	RAIOS-X GNATUS / GNATUS X-RAY / RAYOS X GNATUS

Nº SÉRIE / SERIAL NUMBER	ALIM. 50/60 / POWER SUPPLY / ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE
4153549024	125VAC + 5VAC/60Hz

POTÊNCIA DE ENTRADA / INPUT POWER	TENSÃO NO TUBO / TUBE VOLTAGE / TENSIÓN EN EL TUBO	Nº REGIS. MAS
1300VA	70kVp - 9mA	10229030016

ATENÇAO / ATTENTION / ATENCIÓN

Máxima resistência aparente da rede de alimentação do equipamento:
= 0,1 ohms p/ 127VAC
= 0,2 ohms p/ 220VAC

Utilizar disjuntor para rede de alimentação:
= 15A p/ 127VAC
= 8A p/ 220VAC

Maximum resistance of the equipment power supply:
= 0,1 ohms for 127VAC
= 0,2 ohms for 220VAC

Use the following circuit breaker for the voltages stated below:
= 15A for 127VAC
= 8A for 220VAC

Máxima resistencia de la red de alimentación del equipamiento:
= 0,1 ohms p/ aparato 127VAC
= 0,2 ohms p/ aparato 220VAC

Utilice llave de sobrecorriente para la red de alimentación:
= 15A p/ aparato 127VAC
= 8A p/ aparato 220VAC

Garantido pela Gnatus Equipamentos Médico-Odontológicos Ltda. que este produto está em conformidade com a NBR IEC 60601-1
Guaranteed by Gnatus Equipamentos Médico-Odontológicos Ltda. - That product is in accordance with NBR IEC 60601-1
Garantido por Gnatus Equipamentos Médico-Odontológicos Ltda. que este producto está en conformidad con la NBR IEC 60601-1

ADVERTÊNCIA PARA TRANSPORTE E AUMENTO DE ESTABILIDADE
WARNING: TRANSPORTATION AND STABILITY
ADVERTENCIA PARA TRANSPORTE Y AUMENTO DE ESTABILIDAD

O Equipamento deverá ser transportado com os braços sobrepostos de acordo com a ilustração.
Desta forma terá sua estabilidade aumentada.

In order to increase the equipment's stability, we recommend to keep the arms as shown in the picture.

El equipamiento deberá ser transportado con los brazos sobrepuestos de acuerdo con la ilustración.
De esta forma tendrá mayor estabilidad.




Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e

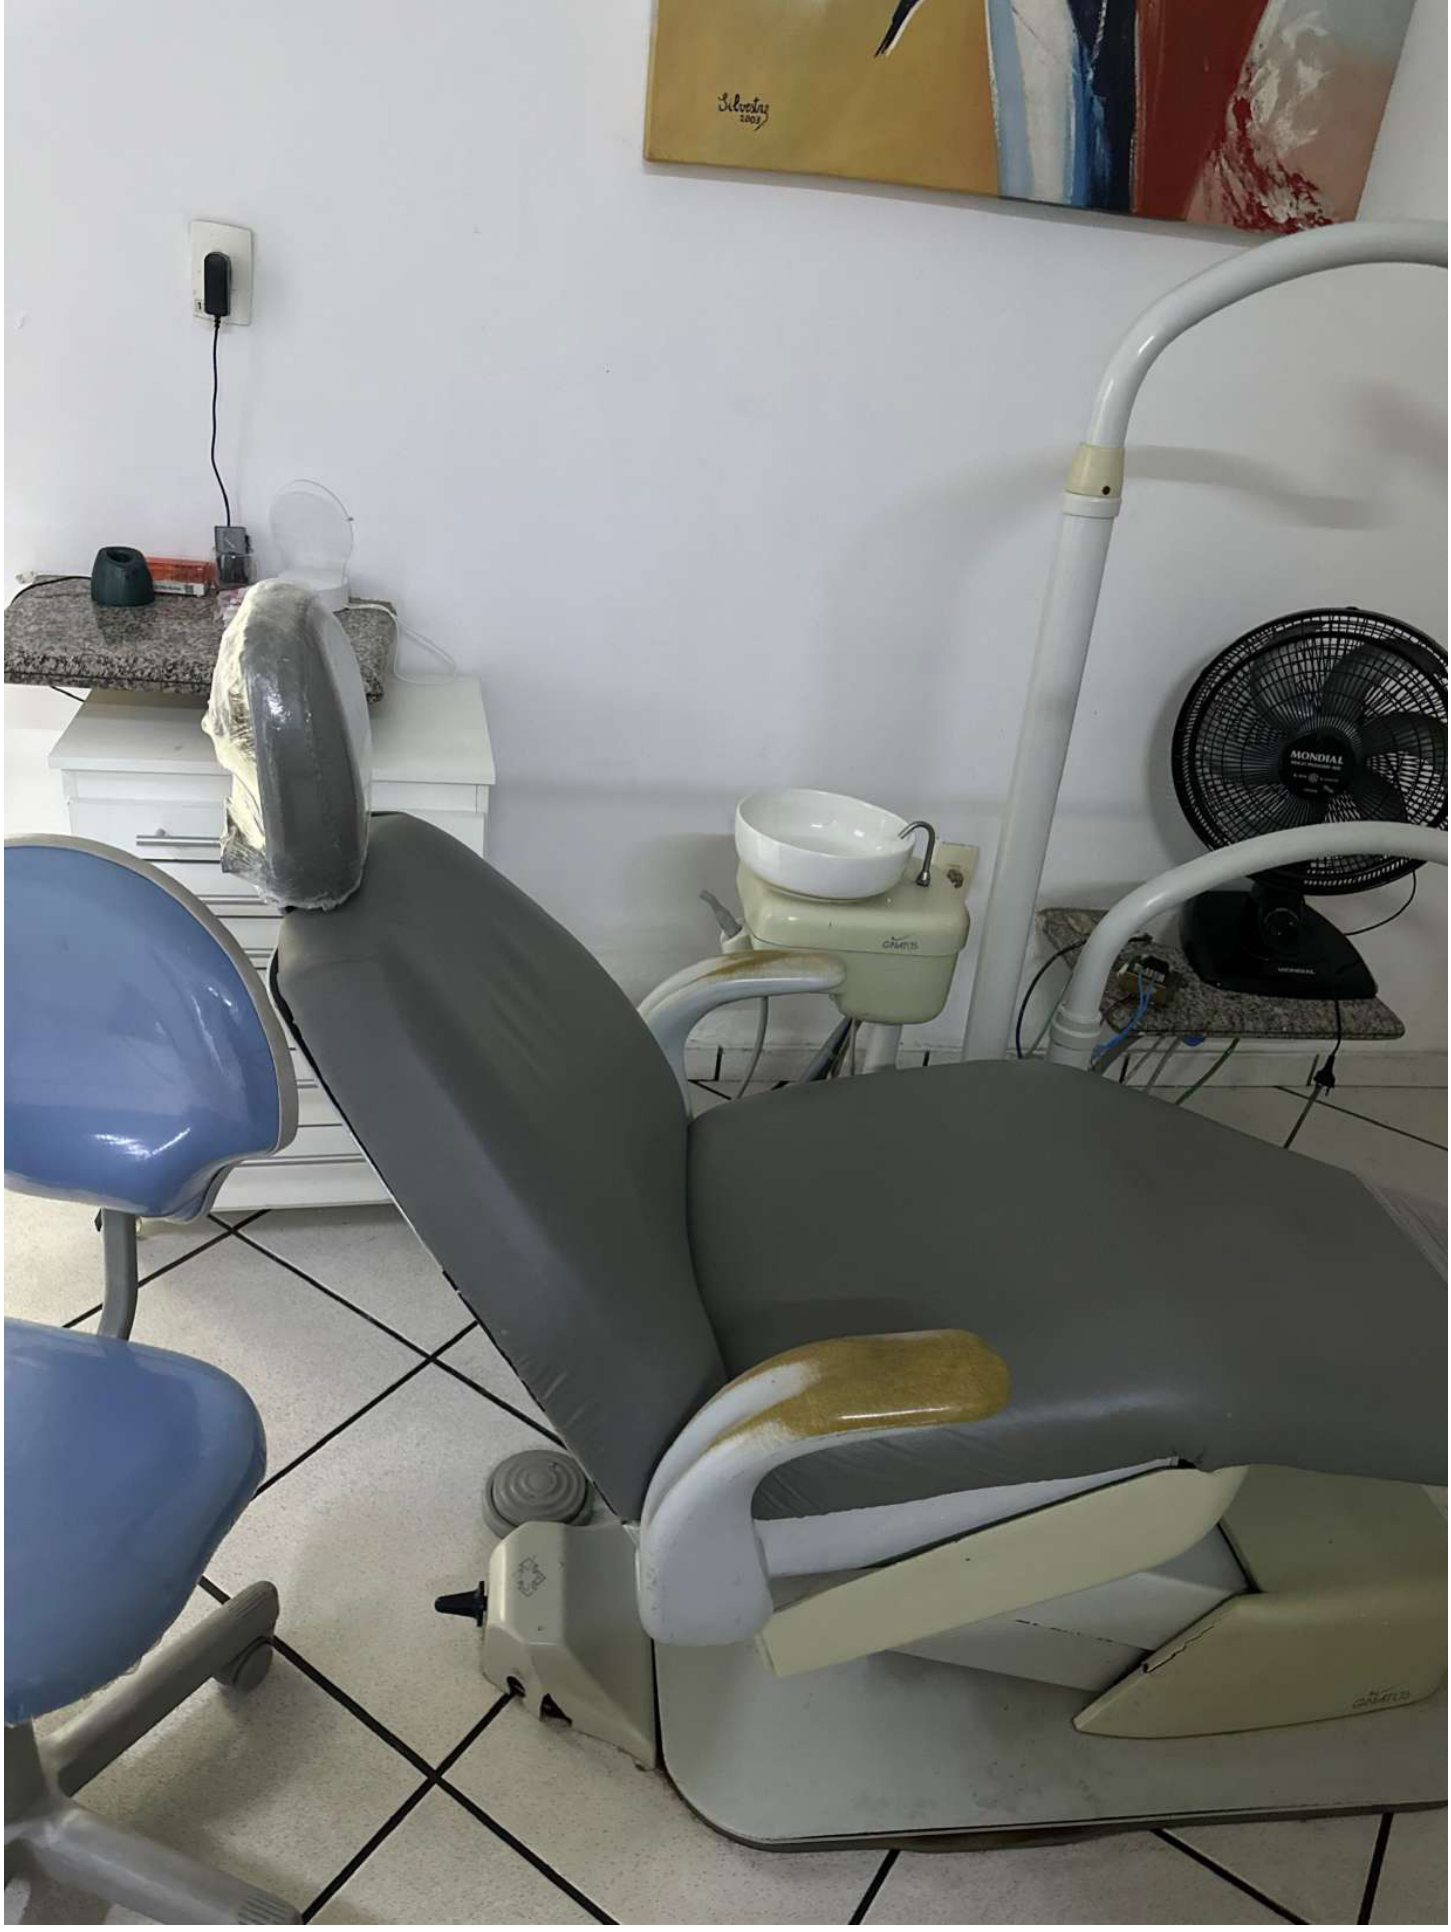

Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner

PJe Documento assinado eletronicamente por DEBORA LETICIA GOMES GAZZOLA , em 22/07/2026, às 16:21:37 - 803828e



Scanned with CamScanner



Scanned with CamScanner